


静脉药物给用：

小药包配合小药瓶（使用重力）

请参阅您的
“输液治疗
入门指南”手册，
了解额外信息。

本文信息不旨在替代专业建议。
请始终遵循您的医生、护士
或药剂师的建议。

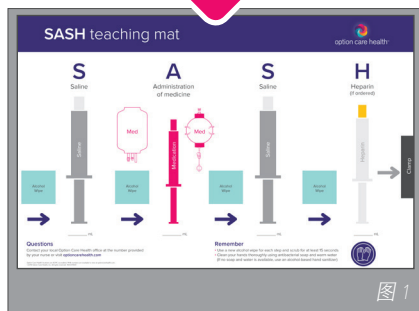

入门指南

- 使用干净的工作区域
- 使用抗菌肥皂和温水彻底清洁双手
(如果没有肥皂和水可用，则使用含酒精的洗手液)
- 用干净的毛巾擦干双手

1 | 按照指示收集用品和准备好您的 SASH 垫：

- A. SASH 垫 (见图 1)
- B. 静脉注射药物袋
- C. 静脉输液管 (可能需要使用 24 小时)
- D. 静脉输液架
- E. 冲洗注射器
 - _____ mL 生理盐水
 - _____ mL D5W
 - _____ mL 肝素 _____ 单位/mL 肝素
- F. 酒精湿巾
- G. 锐器盒 (如需要) 和/或垃圾桶

2 | 检查药物袋

检查药物袋。查看袋上的标签 (见图 2) 并验证：

- A. 患者姓名正确
- B. 药物名称正确
- C. 药物量/数量
- D. 存储说明
- E. 药物的丢弃日期

药物袋应没有泄露、浮动颗粒或变色。如果药物袋有问题或标签上的任何内容不正确，
则联系您的护士或药剂师。



出于演示目的，请遵循您的药物袋上的说明。

静脉药物给用： 小药包配合小药瓶（使用重力）



3 | 准备您的冲洗注射器

- A. 在使用注射器前，先别摘掉注射器头帽，用力推拇指按压件，直到感觉柱塞移动就好。
- B. 拧掉注射器头帽，向前推柱塞，排出空气和多余溶液。按照护士指示的量排出多余溶液。（见图 3）
- C. 重新盖上注射器帽，小心手不要触碰到注射器头。如果碰到，则需要用干净的注射器从头开始。把注射器放在一边备用。
- D. 对需要注射剂量的所有冲洗注射器重复步骤。



4 | 准备您的静脉注射药物


- A. 上下弯折打开小药瓶的密封处。（见图 4）
- B. 拿住药物袋，小药瓶朝下。
- C. 将溶液挤入小瓶直至半满。
- D. 轻轻混合溶液使药物溶解。
- E. 拿住药物袋，小药瓶倒置。（见图 5）
- F. 挤压药物袋，使空气排进小药瓶。
- G. 松手，让混合的药物从小药瓶排出。

重复这些步骤，直到小药瓶倒空药物和溶液。
确保药物完全溶解。不要取下小药瓶。



5 | 灌注您的静脉输液管

- A. 从包装中取出静脉输液管。闭合输液管上的夹具。
- B. 将药物袋放在干净的平面上。
- C. 从药物袋上取下标签。（见图 6）
- D. 取下输液管穿刺器上的护套。（见图 7）
不要触碰末端。
- E. 把输液管末端推入并拧进药物袋插口从而插入药物袋。（见图 8）
确保穿刺器接触到袋中的药物，小心不要穿破袋子。（见图 9）

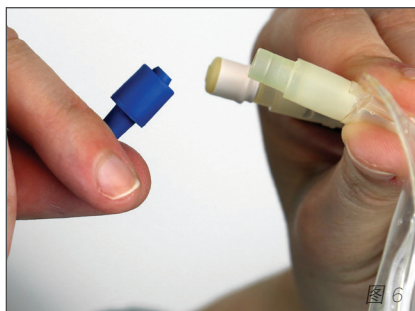

静脉药物给用： 小药包配合小药瓶（使用重力）



5 | 灌注您的静脉输液管 续...

- F. 将静脉药物袋挂在静脉输液架上。轻轻挤压滴注器，将其填充到约 $\frac{1}{2}$ 满液体。**不要**装得过满。（见图 10）
- G. 慢慢打开夹具灌注输液管（向输液管填充药物）。当药物到达输液管末端时，闭合夹具。



6 | 用生理盐水冲洗您的静脉输液管

使用在第 3 步中准备好的一个生理盐水注射器。

- A. 用酒精湿巾擦拭静脉导管上的无针接头至少 **15 秒**，再自然风干。（见图 11）
- B. 取下生理盐水冲洗注射器的保护帽。**不要**在取下保护帽后触碰注射器头。

如果未盖帽的无菌注射器头触碰任何不干净表面，则丢弃该生理盐水冲洗注射器。

- C. 把生理盐水冲洗注射器推入静脉导管上的无针接头，再顺时针扭转，直至牢固连接。（见图 12）
- D. 如有需要，则打开静脉导管和/或静脉输液延伸组件上的夹具。
- E. 用“推/停”法冲洗静脉导管。**不要**在遇到阻力时尝试冲洗；联系您的护士或药剂师。
 - _____ mL 生理盐水
 - _____ mL D5W
- F. 取下生理盐水冲洗注射器并丢入垃圾桶。

静脉药物给用： 小药包配合小药瓶（使用重力）


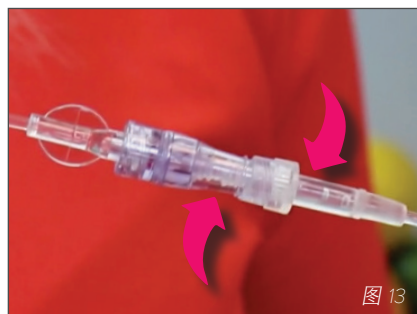


图 13

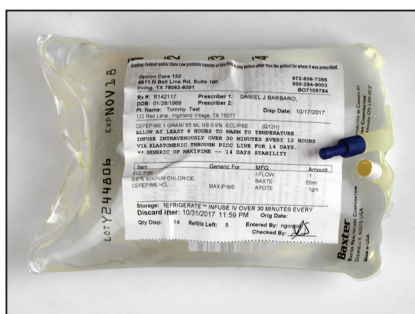

药物

7 | 给用您的药物

- 用酒精湿巾擦拭静脉导管上的无针接头至少 **15 秒**，再自然风干。
(见图 11)
- 取下静脉输液管的保护帽。
- 把静脉输液管用力推入静脉导管上的无针接头，再顺时针扭转，直至牢固连接。(见图 13)
- 如有需要，则打开静脉导管和/或静脉输液延伸组件上的夹具。
(在药物开始输注时，应看到液体一滴一滴进入滴注器。您的滴液率是每 15 秒 _____ 滴。如有需要，使用夹具调整滴液率。)
- 输入规定的剂量后，关闭静脉输液管上的夹具。
- 给用完规定的剂量后，断开静脉输液管的连接。根据指示把所有设备丢入垃圾桶。

如果将在 24 小时内再次使用该输液管，则使用提供的无菌帽盖上暴露的静脉输液管头。

8 | 用生理盐水冲洗您的静脉输液管

使用在第 3 步中准备好的一个生理盐水注射器。

- 用酒精湿巾擦拭静脉导管上的无针接头至少 **15 秒**，再自然风干。
(见图 11)
- 取下生理盐水冲洗注射器的保护帽。
不要在取下保护帽后触碰注射器头。

如果未盖帽的无菌注射器头触碰任何不干净表面，则丢弃该生理盐水冲洗注射器。

- 把生理盐水冲洗注射器推入静脉导管上的无针接头，再顺时针扭转，直至牢固连接。(见图 12)
- 用“推/停”法冲洗静脉导管。**不要**在遇到阻力时尝试冲洗；联系您的护士或药剂师。
 - _____ mL 生理盐水
 - _____ mL D5W
- 除非您得到使用肝素的指示，否则请闭合静脉导管和/或静脉输液延伸组件上的夹具。
- 取下生理盐水冲洗注射器并丢入垃圾桶。

静脉药物给用： 小药包配合小药瓶（使用重力）

9 | 用肝素冲洗您的静脉输液管（如医嘱）

使用在第 3 步中准备好的肝素注射器。

- A. 用酒精湿巾擦拭静脉导管上的无针接头至少 **15 秒**，再自然风干。
（见图 11）
- B. 取下肝素冲洗注射器的保护帽。
不要在取下帽后触碰注射器头。

如果未盖帽的无菌注射器头触碰任何不干净表面，则丢弃该肝素冲洗注射器。

- C. 把肝素冲洗注射器推入静脉导管上的无针接头，再顺时针扭转，直至牢固连接。（见图 12）
- D. 用“推/停”法冲洗静脉导管。**不要**在遇到阻力时尝试冲洗；联系您的护士或药剂师。
 - _____ mL 肝素 _____ 单位/mL 肝素
- E. 如有需要，则闭合静脉导管和/或静脉输液延伸组件上的夹具。
- F. 取下肝素冲洗注射器并丢入垃圾桶。

如有任何疑问或疑虑，联系您的护士或医生



您的 Option Care Health 团队全年每天 24 小时随时协助您。

想要观看教学视频并获取额外教育资源，请访问
optioncarehealth.com/education。

Option Care Health 的位置经过 ACHC 认可。访问 optioncarehealth.com 可查看 HHA 号码。
©2020 Option Care Health, Inc. 保留所有权利。200CH11011

（SASH）程序摘要：

- 用 _____ mL 生理盐水 (**S, Saline**) 或 D5W 冲洗静脉导管
- 给用 (**A, Administer**) 药物 _____ 分钟 _____ 小时
- 用 _____ mL 生理盐水 (**S, Saline**) 或 D5W 冲洗
- 如医嘱，用 _____ mL 肝素 (**H, Heparin**) 冲洗



option care health™